

1

2

3

4

A


A

B

B

C

C

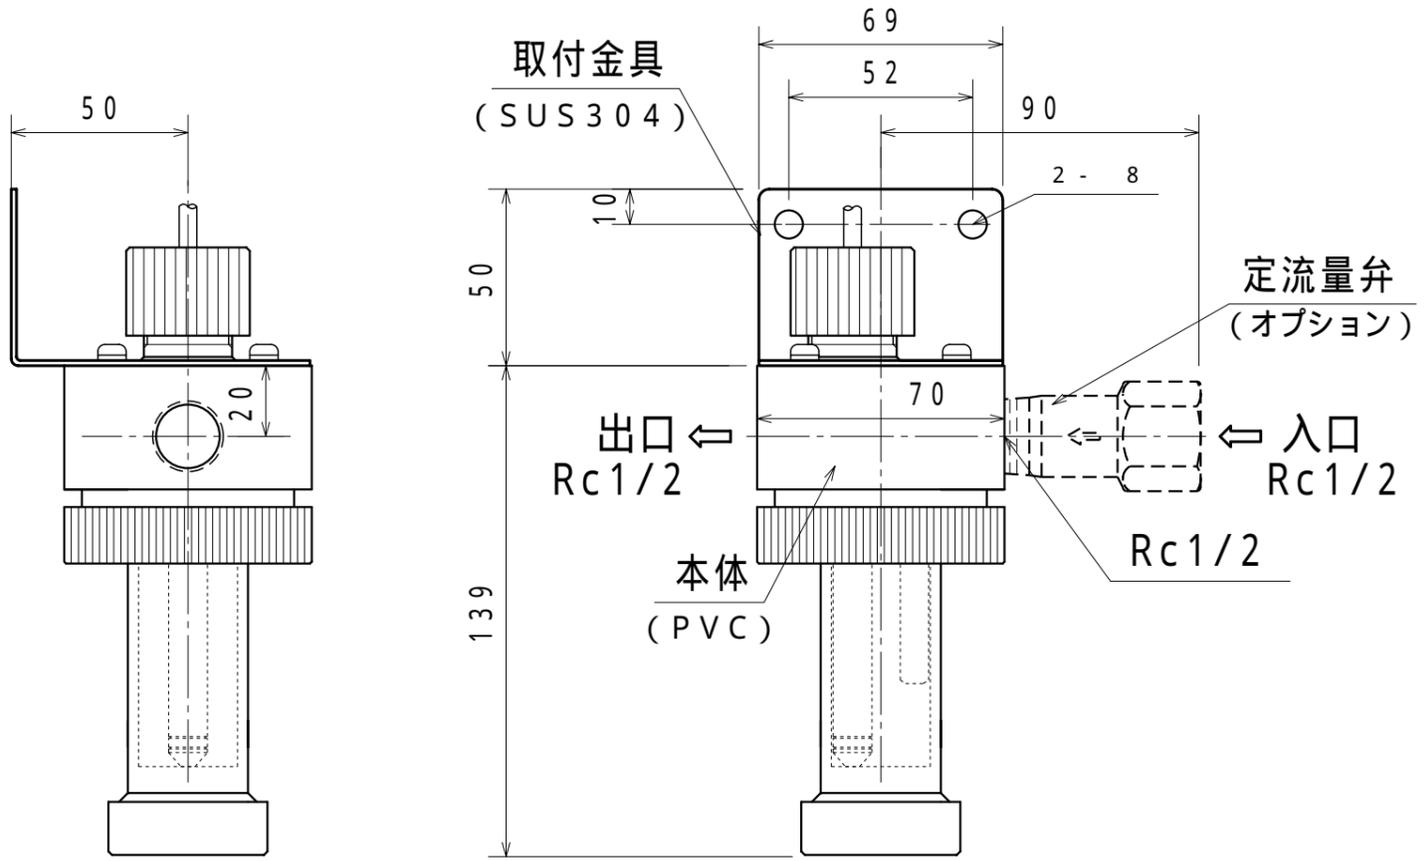

定流量弁付ホルダー仕様


- 1. サンプル水流量
3 l / min ± 8 %
- 2. 作動差圧範囲
0.03 ~ 0.4 MPa
- 3. 耐 圧
0.34 MPa
- 4. 使用温度範囲
0 ~ 45 (凍結なき事)

定流量弁無ホルダー仕様

- 1. サンプル水流量
3 l / min ± 10 %

フィルターでゴミや異物を除去して御使用下さい。
サンプル水採取口を別途に取付けて御使用下さい。

参考フロー図

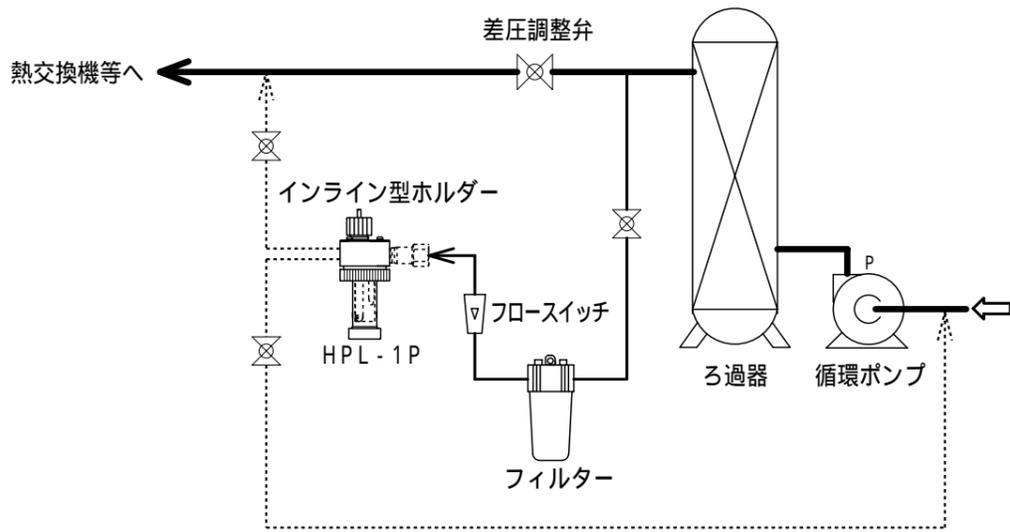

上図のようにホルダーの前後にはバルブを取付けて御使用下さい。

F

F

回数 REV. MARK	変 更 REVISIONS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 称 TITLE
年月日 DATE		T. K	R. K	残留塩素用インライン型ホルダー
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	型式番号 MODEL NO.
変更者 REVISED BY		K. S	Y. A	HPL - 1 P
記事 CONTENTS		単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. 202-0619-HPL1	
	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN			変更回数 ○

1

2

3

4